


Aparat treningowy – bioblok 3

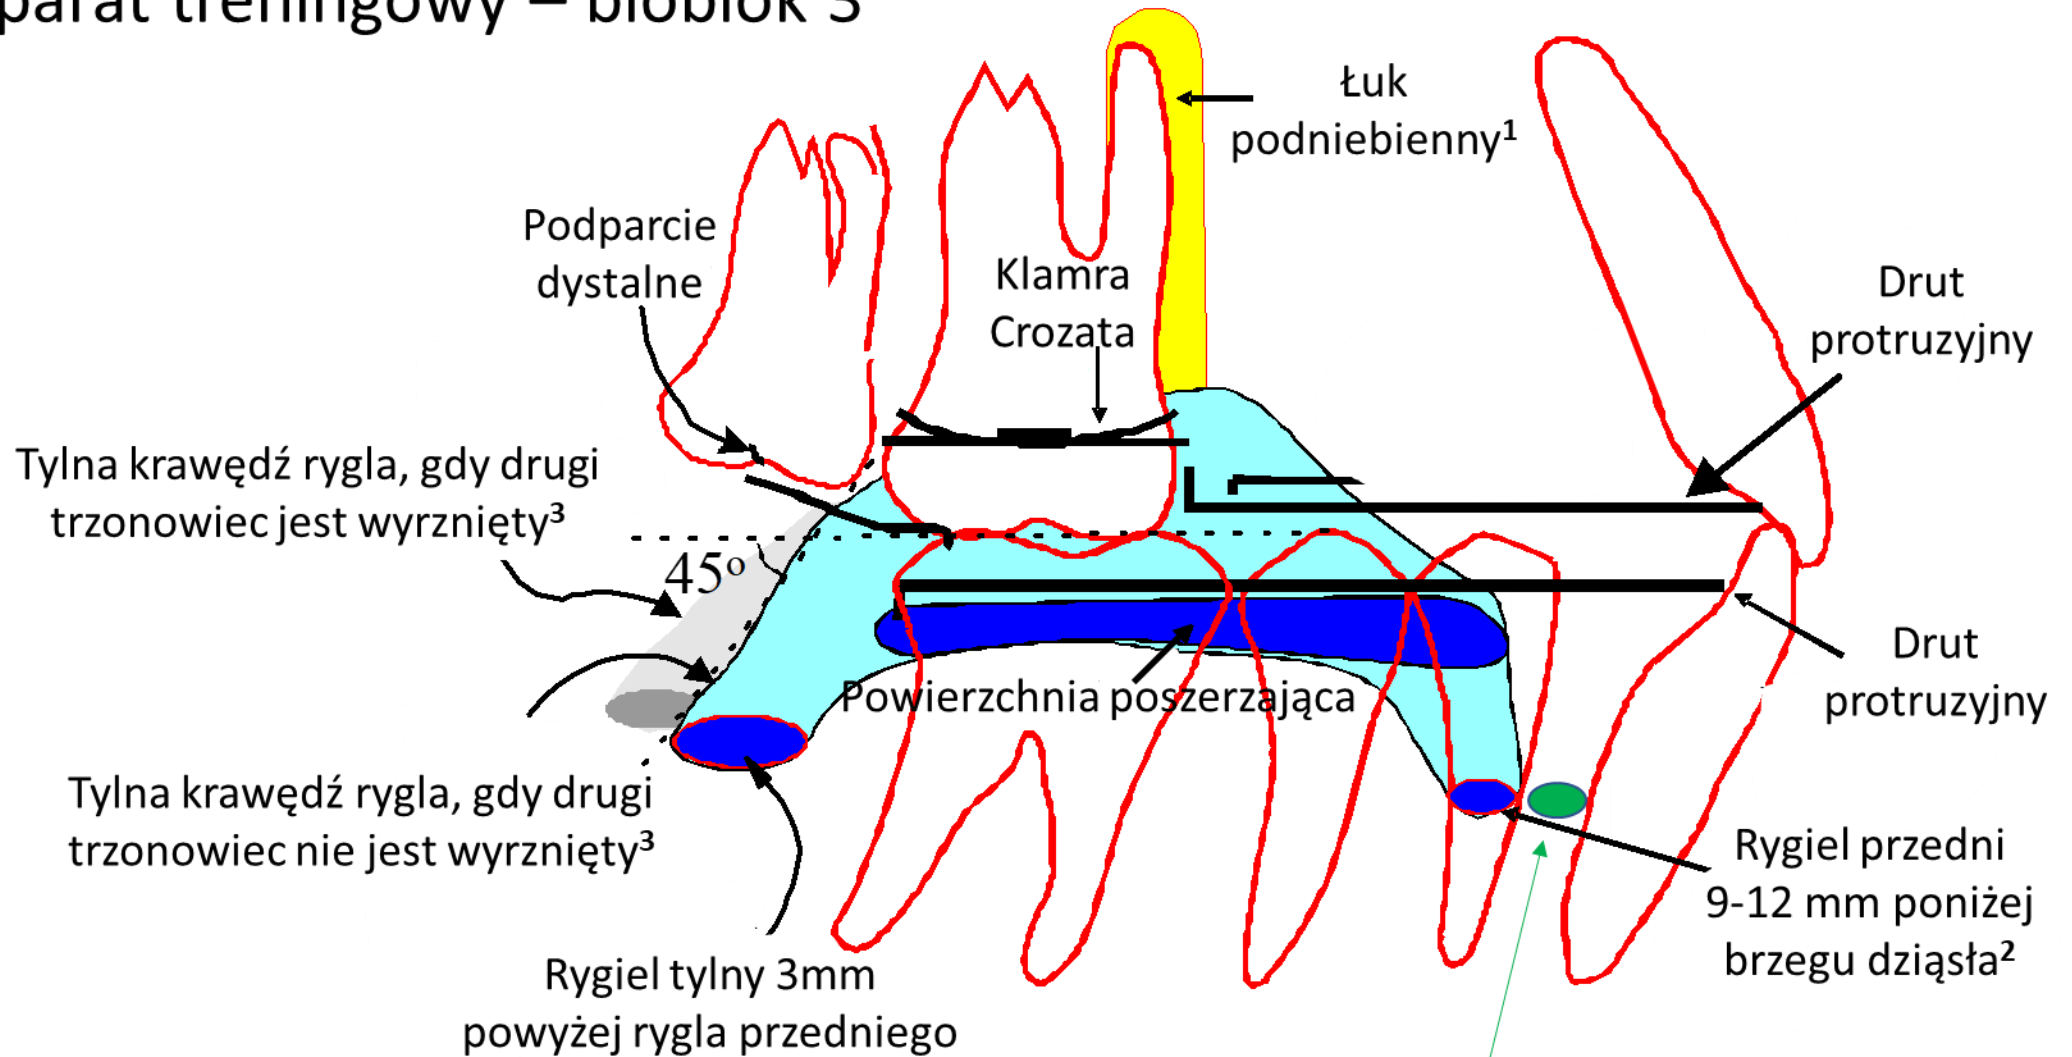

Modyfikacje wg Piskorskiego:

- ¹ montaż dwóch równoległych łuków podniebiennych zwiększa sztywność aparatu
- ² przesunięcie rygla do przodu między kła a przedtrzonowca zmniejsza ryzyko recesji
- ³ wykonanie szerokich tylnych rygli a następnie dopasowanie ich po teście czynnościowym